

BILANCIATI ASSOCIATI s.n.c.

Paganelli Giovanni & C.

Via Ungheri,9/G - 40012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO - BOLOGNA

Tel. 051 725746 - TELEFAX 051 6466728 - www.bilanciati-associati.it

RELAZIONE DI PROVA

N. CAR/01/19 DEL 29/03/2019

RILASCIATA A:

C.A.R. srl Via Laguna 27/A 40026 IMOLA BOLOGNA

RICHIESTA DA:

Resp. Qualità : Sig. Gianluca Minarini

DATI RELATIVI ALLO STRUMENTO IN PROVA

Oggetto: Pesa a Ponte
Costruttore: Soc.Coop.Bilanciati Campogalliano
Modello: SBP/M con terminale D800 e stamp. TMU 295
Matricola: K 180094 Matr.interna:
Classe di precisione: III
Portata: 80000 kg
Divisione(e): 20 kg

Dimensioni : 18 x 3 m

Situato presso: Piazzale esterno/ufficio

Data delle misure: 20/03/2019

Controlli effettuati: le prove eseguite con carico decentrato e di carico, sono state condotte con procedure ricavate dalla: OIML R76

Bilanciati Associati snc



Partita Iva e Codice Fiscale 01221330374

IMPRESA ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA N. 25690

BILANCIATI ASSOCIATI s.n.c.

Paganelli Giovanni & C.

RELAZIONE N° CAR/01/19 DEL 29/03/2019

PROVA CON CARICO DECENTRATO

Il carico è stato posizionato nei punti indicati numericamente seguendo lo schema:

B

Schema A

2	4
5	
1	3

Schema B

2	4	6	8
1	3	5	7

Il dispositivo di mantenimento dello zero è: escluso

POSIZ.	CARICO kg	INDICAZ. kg	CAR.ADD. kg	ERRORE kg	ERRORE CORR. kg	EMT kg
valore iniziale	0	0	12	-2	0	20
1	11500	11500	10	0	2	40
2	11500	11500	12	-2	0	40
3	11500	11500	8	2	4	40
4	11500	11500	10	0	2	40
5	11500	11500	8	2	4	40
6	11500	11500	8	2	4	40
7	11500	11500	10	0	2	40
8	11500	11500	10	0	2	40
9						
10						
11						

BILANCIATI ASSOCIATI s.n.c.

Paganelli Giovanni & C.

RELAZIONE N° CAR/01/19 DEL 29/03/2019

PROVA DI CARICO

Il dispositivo di mantenimento dello zero è: escluso

CAMPIONI UTILIZZATI:

MASSE CAMPIONE DA 20 kg MATR. DA 01 a 50 CERT.N°M170087

MASSE CAMPIONE DA 1000 - 2000 kg MATR.(vedi note) CERT.N° 086 - 121/2018

MASSE CAMPIONE DA 1mg a 10kg MATR. 2306 CERT.N°M180365

MASSE CAMPIONE DA 1000 kg MATR. 1-6-7-9-10 CERT.N° M150326

Per il raggiungimento della portata max di prova sono stati utilizzati carichi mobili(zavorre)

per un totale di 45000 kg

CARICO kg	INDICAZIONE		CAR.ADD.		ERRORE		ERRORE CORR.		EMT kg
	SALITA kg	DISCESA kg	SALITA kg	DISCESA kg	SALITA kg	DISCESA kg	SALITA kg	DISCESA kg	
0	0	0	12	10	-2	0	0	2	20
4500	4500	4500	10	8	0	2	2	4	20
8500	8500	8500	12	8	-2	2	0	4	20
12500	12500	12500	10	6	0	4	2	6	40
16500	16500	16500	10	6	0	4	2	6	40
20500	20500	20520	8	10	2	20	4	22	40
30500	30500	30520	8	10	2	20	4	22	40
39500	39520	39540	10	12	20	38	22	40	40
65500	65540	65540	10	10	40	40	42	42	60

LEGENDA

- CARICO: valore nominale dei campioni
- INDICAZIONE: valore rilevato sullo strumento di prova
- CARICO ADDIZIONALE: valore dei pesi campione necessari per fare scattare la divisione successiva
- e: valore della divisione dello strumento di prova (vedi prima pagina)
- ERRORE: indicazione + (0,5 x e) - carico addizionale - carico
- ERRORE CORRETTO: errore - errore del primo valore rilevato (valore evidenziato in grassetto)
- E.M.T. errore massimo tollerato dato fornito dalle Raccomandazioni Internazionali OIML R 76
- Il valore EMT è pari a+/-1 divisione le prime 500 divisioni del campo di misura dello strumento
a+/-2 divisioni da 500 a 2000 divisioni del campo di misura dello strumento
a+/-3 divisioni oltre le 2000 divisioni del campo di misura dello strumento


BILANCI ASSOCIATI s.n.c.

Paganelli Giovanni & C.

RELAZIONE N°

CAR/01/19 DEL 29/03/2019

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL' ANDAMENTO DELLO STRUMENTO IN FUNZIONE DEL CARICO

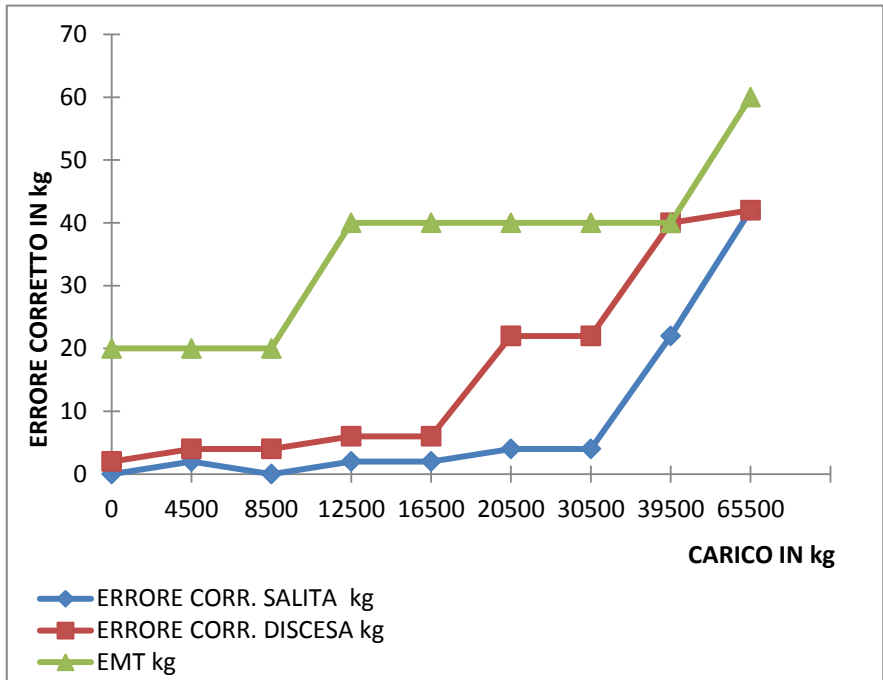

NOTE: Matr. Masse da 1000 kg: 1001 -1002

Matr. Masse da 2000 kg : 2001-2002-2003-2004-2005-2006

LE TOLLERANZE VISUALIZZATE SUL GRAFICO SONO SEMPLICEMENTE INDICATIVE.

SI SOTTOLINEA CHE L'ERRORE MASSIMO TOLLERATO E' UN VALORE INDICATIVO IN QUANTO

LA TOLLERANZA DELLO STRUMENTO IN PROVA DIPENDE DALLE ESIGENZE PRODUTTIVE.

Partita Iva e Codice Fiscale 01221330374

IMPRESA ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA N. 25690